

仕様書

1 調達物品

再加熱カート 一式

2 納入先、規格及び数量

No.	納入先	品名	規格	数量	備考	付属品
1	高田病院	再加熱カート	CD1048SP PHC(株)製	1台	48 膳 間仕切り着脱有 (インサートカート 2台付)	・標準トレイ 70 枚 型番:CD1801 寸法:470*330
		インサート カート 24 膳	CD1724SA PHC(株)	2台	間仕切り+専用台車	
		汁椀蓋	U-63 96mm×24mm	30 個		
		汁椀	U-62 106mm×61mm	30 個		
		汁椀蓋	U-61 93mm×30mm	90 個		
		汁椀	U-60 103mm×24mm	90 個		
		飯椀蓋	U-89 142mm×28mm	30 個		
		飯椀	U-88 140mm×50mm	30 個		
		飯椀蓋	U-85N 131mm×29mm	90 個		
		飯椀	U-84 129mm×54mm	90 個		
		フリーボール (蓋)	U-71W 139mm×30mm	120 個		
		フリーボール	U-70 137mm×50mm	120 個		
		楕円皿 (蓋)	U-151W 182mm×122mm ×30mm	120 個		
		楕円皿	U-150 180mm×119mm ×40mm	120 個		
		楕円皿 (蓋)	U-149W 152mm×122mm ×35mm	120 個		
		楕円皿	U-148 152mm×122mm ×32mm	120 個		

		小鉢（蓋）	U-31W 102mm×25mm	120 個		
		小鉢	U-30 100mm×45mm	120 個		
		角小鉢（蓋）	U-41W 107mm×107mm ×25mm	120 個		
		角小鉢	U-40 105mm×105mm ×45mm	120 個		

※上記に示すメーカーの製品以外で、同等以上の機能を有するものであれば入札可とする。


ただし、所定の申請書に同等品の使用が分かるカタログを添えて提出し、事前に審査を受けること。

3 能力・機能(参考)

- (1) 48 膳を 1 人で運搬が可能なカート型であり、走行はパワーアシスト式であること。
- (2) 庫内間仕切りは着脱可能であること。
- (3) トレータイプは標準モデルであること。
- (4) 電源は再加熱カート 1 台につき三相 200V×2 系統を使用し、マグネットコンセントによるワンタッチ接続であること。
- (5) 庫内全体を冷却する全室冷却機能を装備し、再加熱と温冷配膳車の両機能が装備されていること。
- (6) 加熱運転が始まると自動的に全てのドアがロックされ、高温状態の庫内に手を触れるのを防ぐ、熱保護ドアロック機能を装備していること。
- (7) 加熱や冷却の開始や温度設定などはタッチパネルで操作でき、カラー液晶で分かりやすい日本語表示であること。また、操作画面の背景が、加熱・冷却中は赤色、全室冷却中は青色と、運転状況が一目でわかる仕様であること。
- (8) 機器の異常時に迅速なメンテナンス対応ができるよう、異常が発生した室内の温度表示器にエラーコードが表示されること。
- (9) 機器本体の寸法、消費電力、材質等の詳細については別紙図面を参考とすること。

4 その他

- (1) 入札金額は機器本体、付属品の他、運搬費、電源接続費（ツールバランサー取付含む）等の納入に伴う一切の費用を含むものとする。
- (2) 必要に応じ、現地確認を行うこと。ただし現地確認を行う際は、必ず事前に必要事項を記載した現地確認申請書(任意書式)及び検便検査書を担当課へ提出すること。
- (3) 機器納入後は、調理員に対し取扱説明を行うこと。
- (4) 入札参加業者は、一般社団法人 日本厨房工業会に所属(本社でも可)しており、1 級厨房設備施工技能士の資格を有する者が当該事業所に在籍(雇用関係が 1 年以上継続)していること。

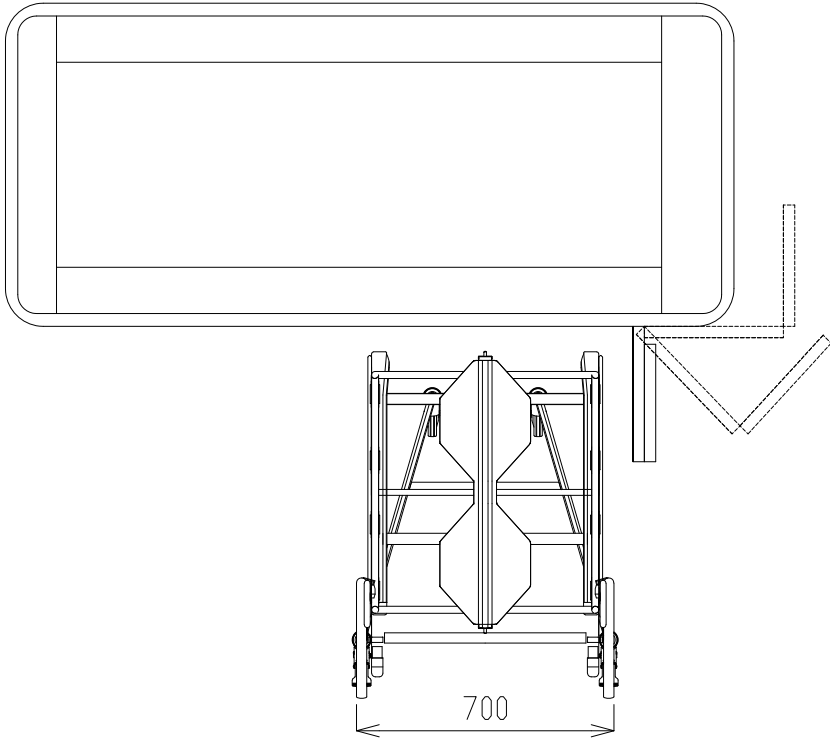

【納入場所】

病院名	数量
高田病院	1台
合計	1台

《Parts List》





No	部品名	材質 仕様	数量
①	本体内装	JFE443CT アルミニウム	
②	本体外装	アクリル変性塩ビ	
③	天板	JFE443CT	
④	肩パネル	JFE443CT	
⑤	扉	JFE443CT塗装	4
⑥	ハンドル	SS塗装	2
⑦	駆動輪	ゴム φ250	2
⑧	自在輪	ゴム φ150	4
⑨	バンパー	アクリル変性塩ビ	
⑩	電源パネル		
⑪	コンセント	4P20A マグネット式	2
⑫	タッチパネル		
⑬	冷凍機		
⑭	バッテリー		2
⑮			

《Spec》

品名	再加熱カート
品番	CD1048SP
寸法(L×W×H)	1930×855×1855 (mm)
重量	560kg (推定) ※間仕切込
トレイ数	4列×12段=48膳 (85?/段)
使用トレイ	470×330 (大トレイ)
電源	3相 200V 50/60Hz
消費電力 (電流)	加熱・冷却時 11.5kW
	内訳 【1】5.5kW (18A)
	【2】6.0kW (17.2A)
	全室冷却時 2.9kW
排熱 (最大)	内訳 【1】1.4kW (7.0A)
	【2】1.5kW (4.2A)
	加熱・冷却時 5500kcal
	全室冷却時 2900kcal

品名	間仕切り台車
品番	CD1724SA
寸法(L×W×H)	920×700×980 (mm)

【備考】
ヒーター容量9kWです。

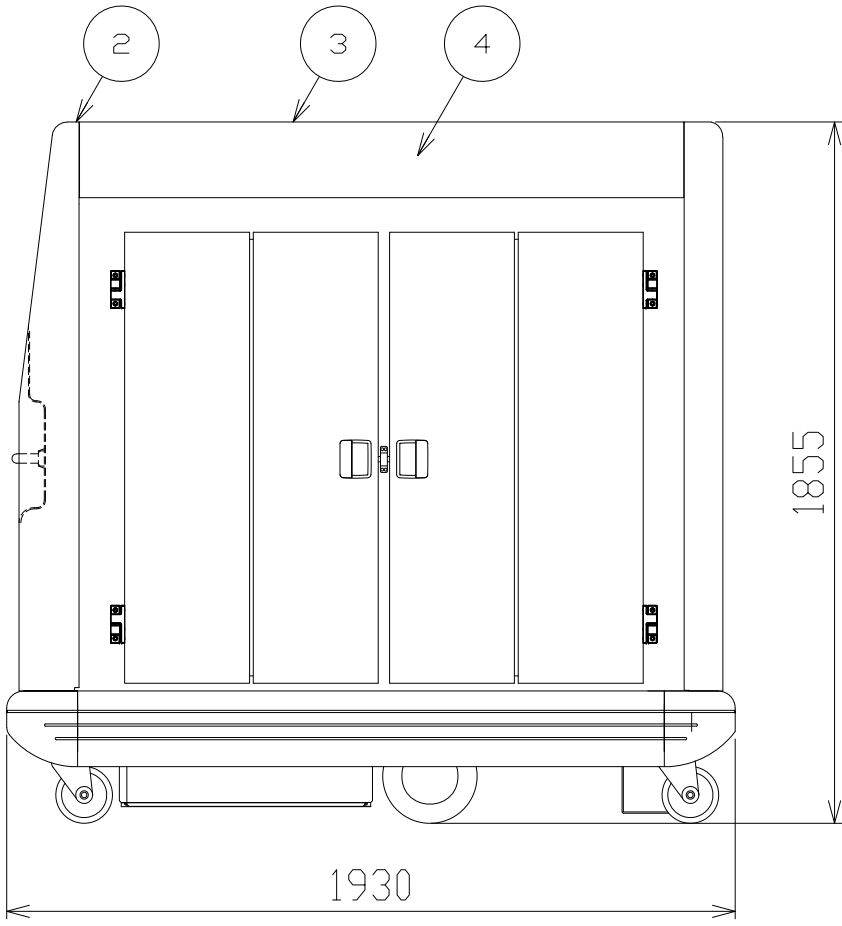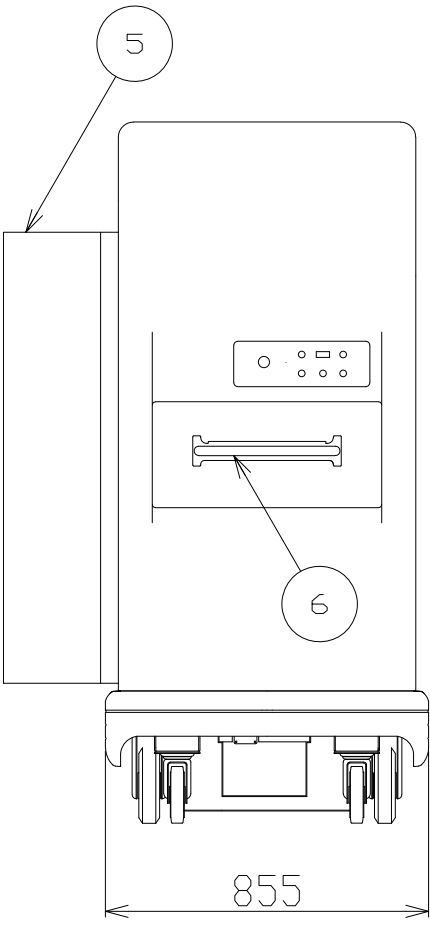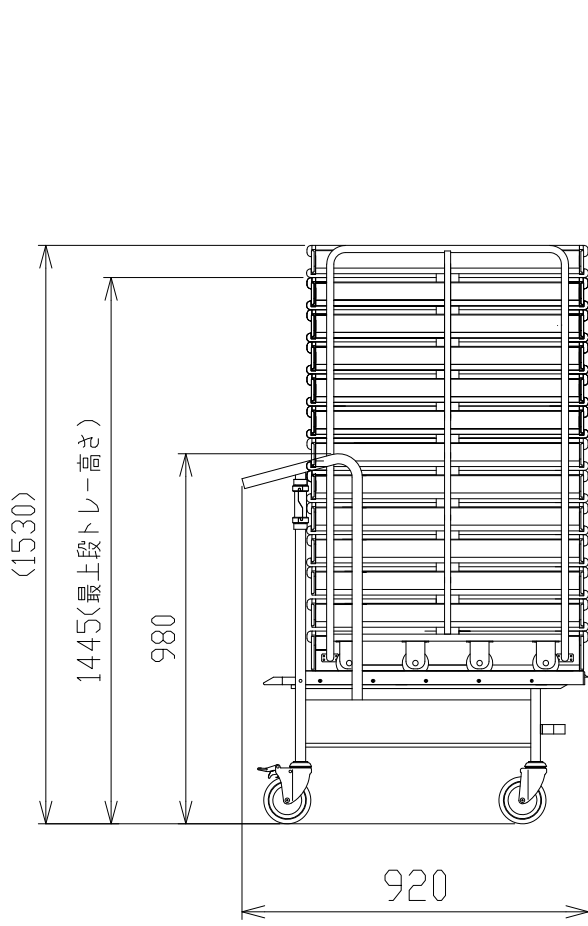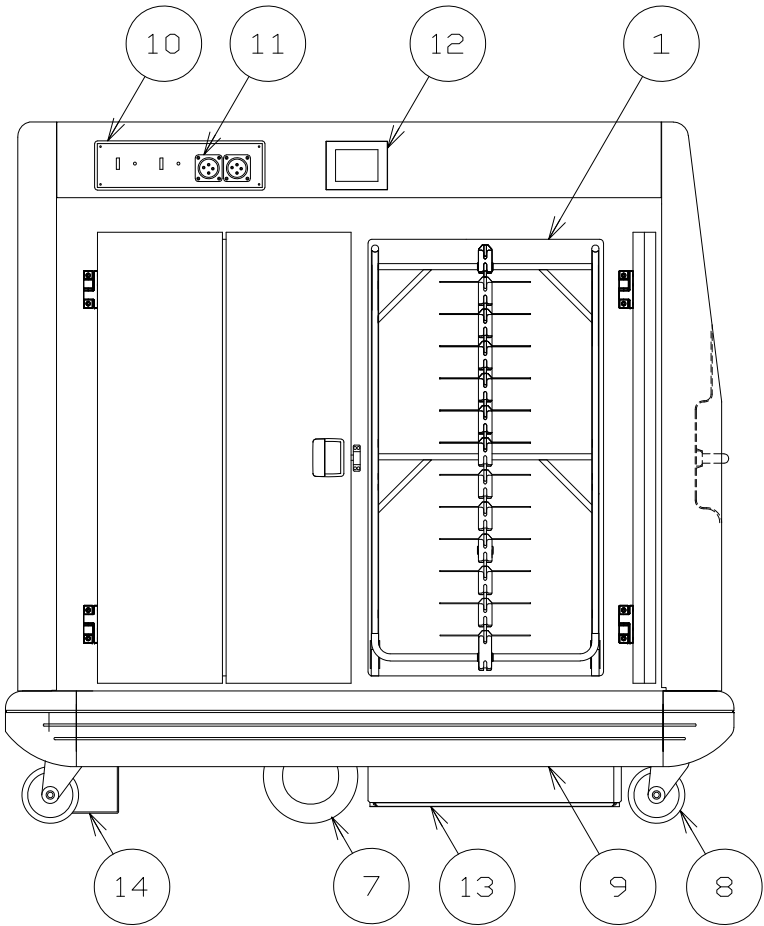

岩手県医療局	*	DATE *	規格・寸法 CD1048SP				* — *
			図面名称 再加熱カート 48膳	No. 1	Quant. NN	SCALE 1/20	

【納入場所】




病院名	数量
高田病院	2台
合計	2台

《Parts List》

No	部品名	材質 仕様	数量
①	カート	SUS304	1
②	車輪レール	SUS304	2
③	サイドプレート	POM	2
④	ハンドル		2
⑤	自在輪	ウレタン φ125	2
⑥	自在輪 ロック付	ウレタン φ125	2
⑦	間仕切りユニット		1

《Spec》

品名	間仕切ユニット+台車
品番	CD1724SA
寸法(L×W×H)	920×700×1530 (mm)
重量	60kg (推定)
使用トレイ	470×330 (大トレイ)

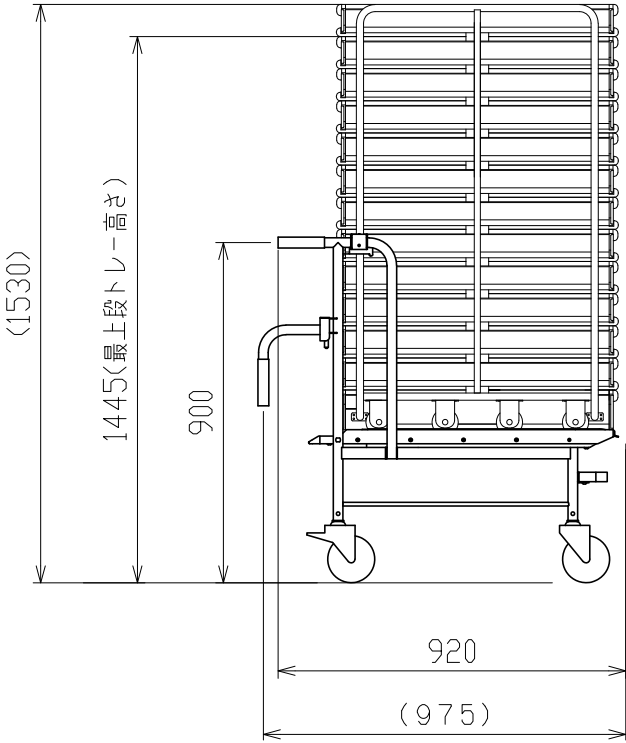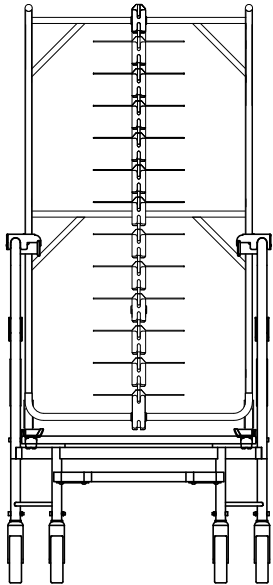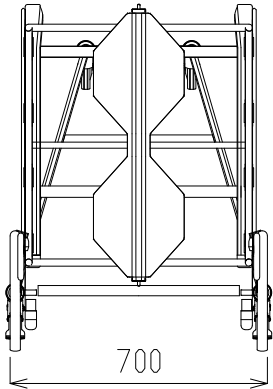

岩手県医療局		*	DATE *	規格・寸法 CD1724SA				* — *
			FILE *	図面名称 再加熱カート 間仕切ユニット+台車	No. 2	Quant. NN	SCALE 1/20	